

青海康力亚医疗器械有限公司

关于产品备案证书取消备案及防范假冒产品的严正声明

鉴于近期市场环境变化及我司经营战略调整,结合市场监管部门反馈及消费者投诉情况,我司美团、京东等平台存在不法分子冒用我司资质、伪造产品备案证书及生产批号销售产品等违法行为,严重损害我司商誉及消费者权益。为明确责任、维护市场秩序,现就相关事项严正声明如下:

一、产品备案证书取消备案公示

根据《医疗器械监督管理条例》及相关法规要求,我司以下产品备案证书已依法办理取消备案手续,具体信息如下:

青械备 20170002 号、青械备 20170003 号、青械备 20170004 号、青械备 20170006 号、青械备 20170007 号:取消备案日期 2024 年 4 月 27 日;

青宁械备 20220012:取消备案日期 2024 年 5 月 1 日;

青械备 20170001 号:取消备案日期 2024 年 6 月 30 日;

青宁械备 20150002 号、青宁械备 20150003 号、青宁械备 20150005 号、青宁械备 20150004 号、青宁械备 20220010、青宁械备 20220011:取消备案日期 2024 年 7 月 9 日;

本公司营业执照主体于 2025 年 3 月 13 日注销,不再经营。

特别提示:上述备案证书取消备案后,任何标注生产日期或批号晚于取消备案日期的产品,均属非法仿冒品,请消费者立即停止购买使用,并向市场监管部门举报。

二、重点产品风险警示

经核查，以下产品已无合法库存流通，现严正声明：

“葵花牌静脉曲张型医用退热凝胶”

“健医师牌痛风型医用退热凝胶”

“妥能牌静脉曲张医用退热凝胶”

自本声明发布之日起，任何渠道销售的相关产品均未经我司授权，系假冒伪劣商品。消费者如发现此类产品，请立即通过官方渠道举报。

三、真伪鉴别指引

为保障消费者权益，我司提供以下防伪特征对比说明：

生产批号打码格式

正品特征：点状不连续数字；数字“2”下方拐点呈竖向走势；


数字“1”底部无横杠；数字“4”下方尾部较长。

仿冒品特征：打码格式粗糙，数字形态与上述标准明显不符（详见附件图示）。

以上声明望各销售平台知悉，并协助下架相关侵权产品维护我司及消费者的合法权益。

青海康力亚医疗器械有限公司

法人签字：



2025年04月23日


附件 1

图一为我公司统一打码格式（真）

生产批号 24042601
生产日期: 20240427
有效期至: 20270426

荆竹
印亚

图二为投诉产品打码格式（假）

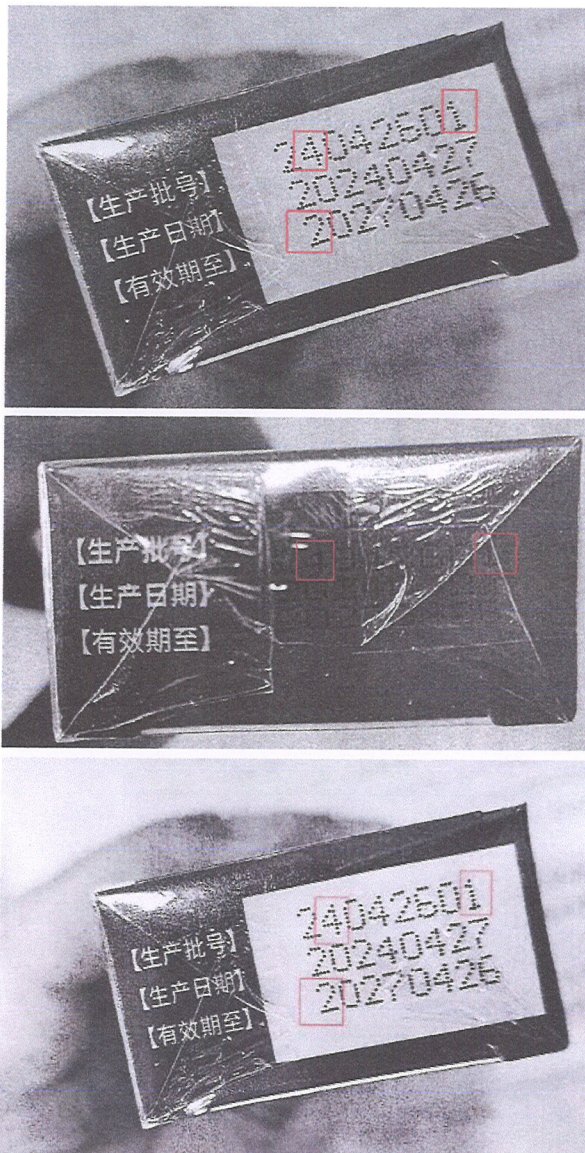


附件 2

1、妥能药业牌静脉曲张型医用退热凝胶 包装图



2、健医师牌痛风型医用退热凝胶 包装图

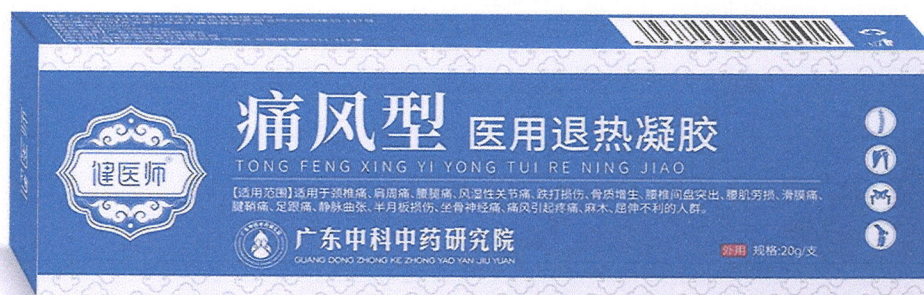

3、葵花牌静脉曲张型医用退热凝胶 包装图

